

Утверждено

Директор ГБПОУ «ВКУИТ им. Ю. Гагарина»

*С. Е. Лиховцов*  
20\_\_ г.

Лиховцов С.Е.




Учебный корпус №3, г. Волгоград, ул. им. Г. Титова, 1,  
Мастерская «Лабораторный химический анализ» - (1)

Брифинг зона - (2)

Комната участников - (3)

Комната эксперта - (4)

Комната главного эксперта - (5)

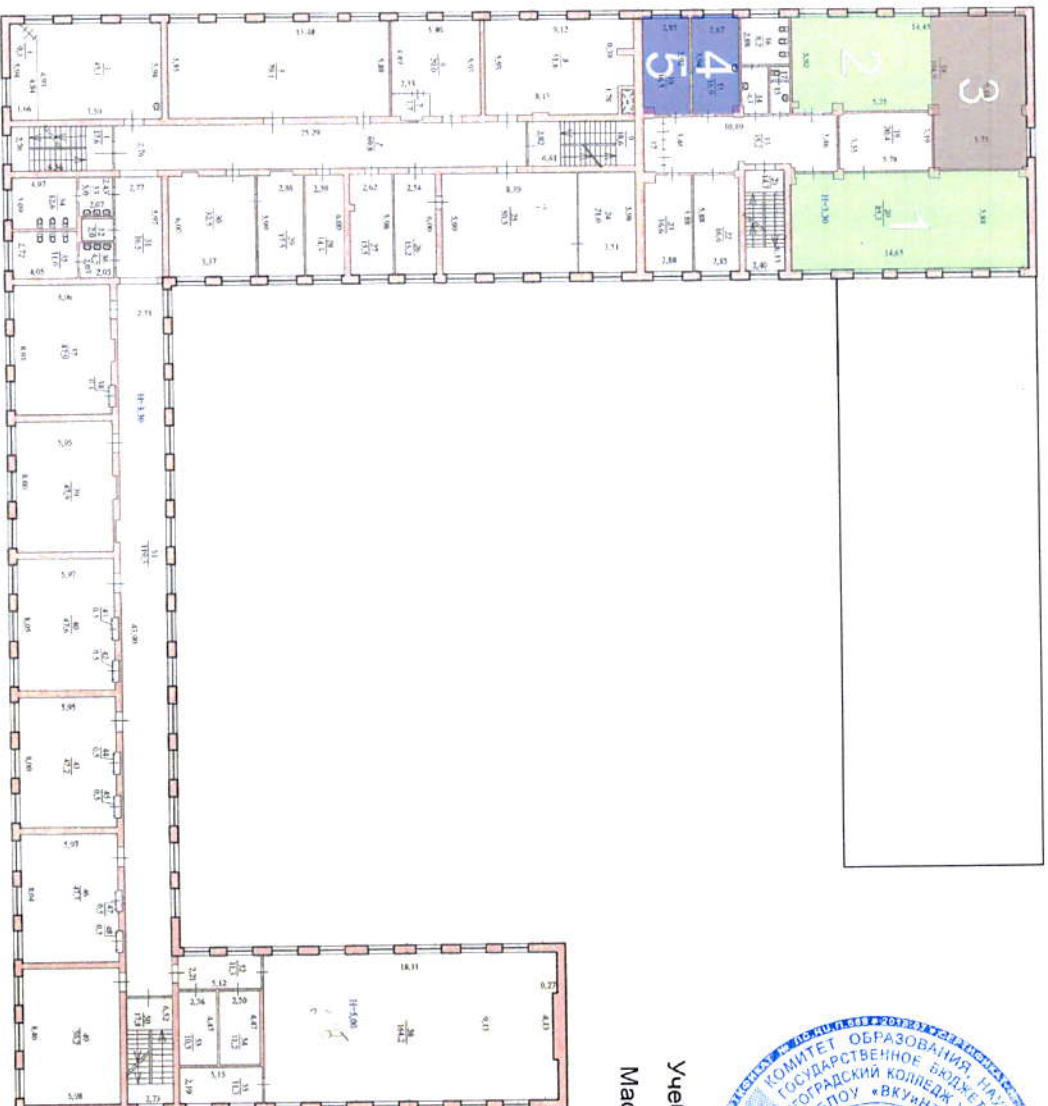

Утверждаю

Директор ГБПОУ «ВКУИТ им. Ю. Гагарина»

« 25 » 10


2015 г.

Лиховцов С.Е.

План застройки мастерской  
по компетенции «Лабораторный химический анализ», код 1.1

14,65

5,88

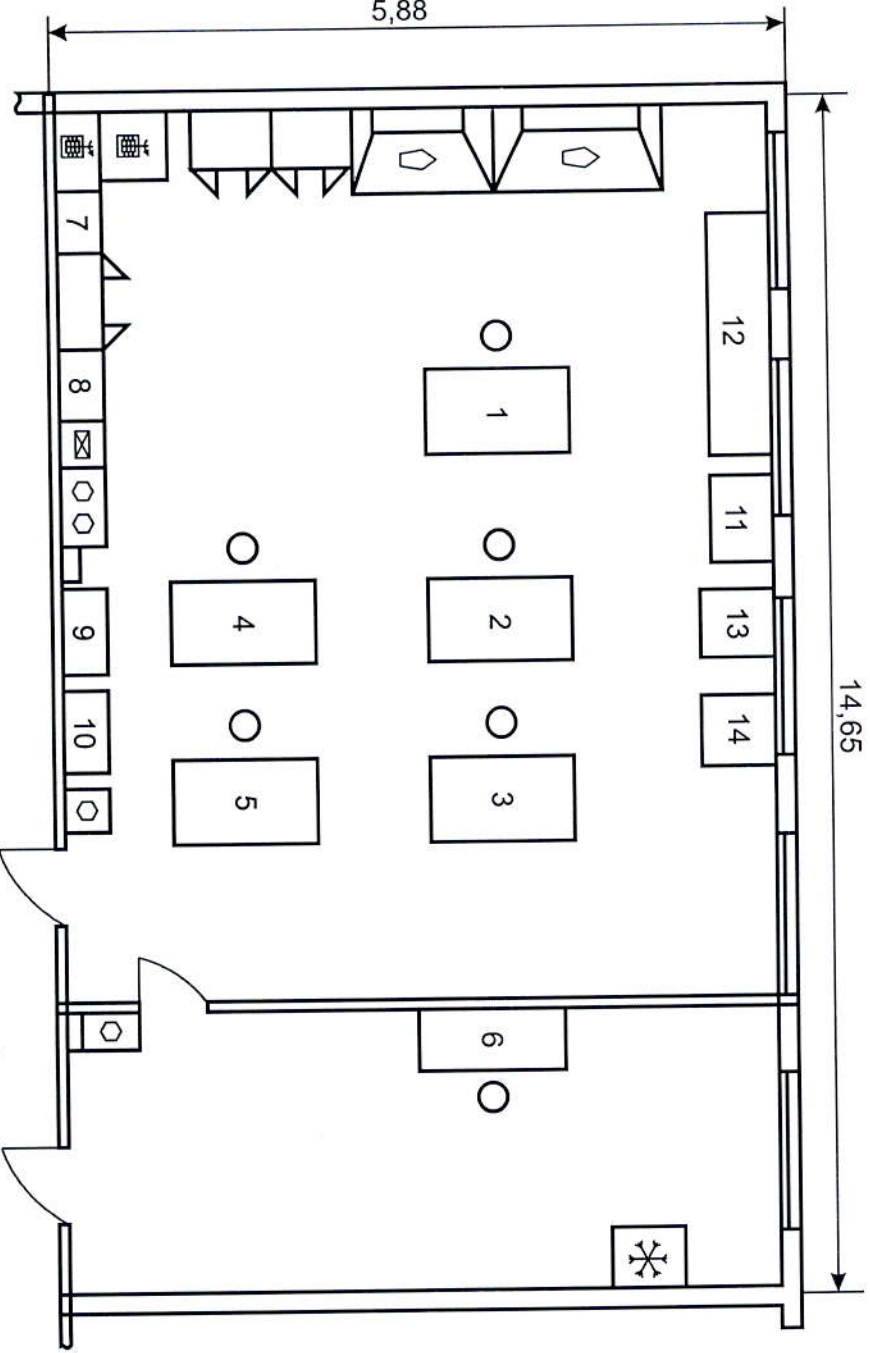

- 1,2,3,4,5 - стол лабораторный
  - 6,14 - стол компьютерный
  - 7,8,9,10 - стол антивибрационный
  - 11 - рефрактометр
  - 12 - спектрофотометр
  - 13 - МФУ
- ☒ - дистиллятор
  - ❄ - холодильник
  - ⬜ - шкаф для посуды
  - ⬡ - стол мойка
  - ⬠ - вытяжной шкаф
  - ⬢ - сушильный шкаф

